

## WIDEX MENU™10 CIC/IIC




Новое решение Widex с 10 каналами и большой гибкостью в использовании.

В основе MENU платформа Flex, которая позволяет Вам «строить» слуховой аппарат с учетом индивидуального нарушения слуха пациента.

Дополнительные функции для лучшей работы и звучания.

От минимальной до умеренно тяжелой потери слуха.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ

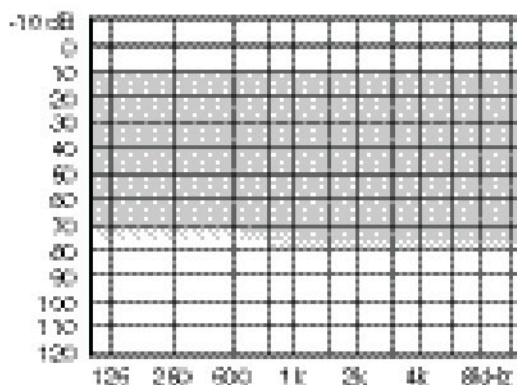

- 10 каналов
- Платформа Flex

## БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

- Высокоуровневая компрессия
- Автоматический контроль мощности выходного сигнала
- Стабилизаторы TruSound
- Шумоподавление SIS
- Направленные микрофоны Всенапр./Напр.
- Активное Устранение Обратной Связи
- 2 программы прослушивания
- SmartTone

## ОПЦИЯ/ЗАВИСИТ ОТ СТРАНЫ


- Высокоточный локатор с Speech Tracer
- Усилитель Речи
- Дневник звука
- SmartSpeak™
- Расширитель Диапазона Слышимости™
- Zen
- До 3 дополнительных программ прослушивания
- АКССУАРЫ
- Пульт ДУ для CIC (опция)

# ME10-CIC/IIC

## МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД – ИСКУССТВЕННОЕ УХО

IEC 60118-0


Output dB SPL

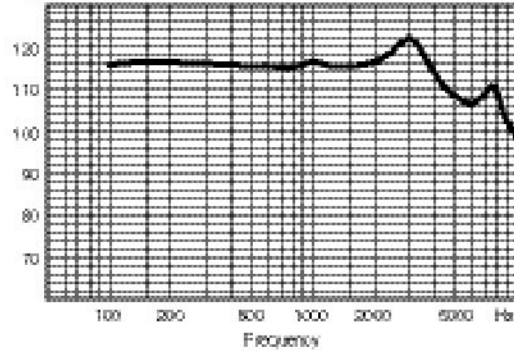

## МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД – КАМЕРА 2СС

IEC 60118-7 / ANSI S3.22-2009


Output dB SPL

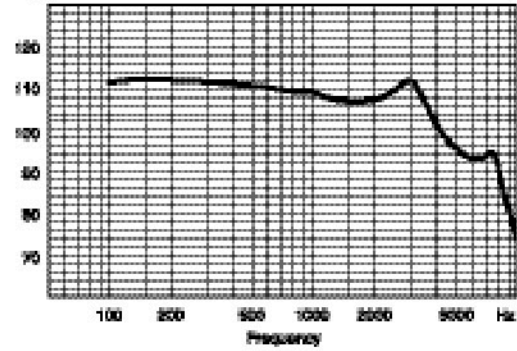

## ВЫХОД – ИСКУССТВЕННОЕ УХО

IEC 60118-0


Output dB SPL

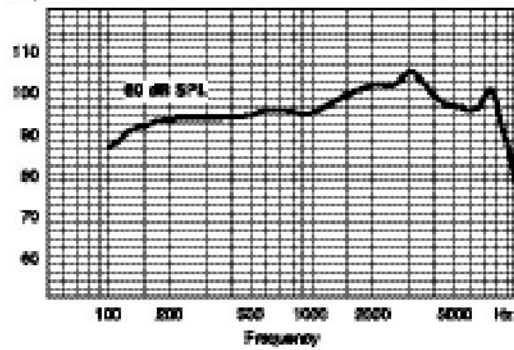

## ВЫХОД – КАМЕРА 2СС

IEC 60118-7 / ANSI S3.22-2009

Output dB SPL

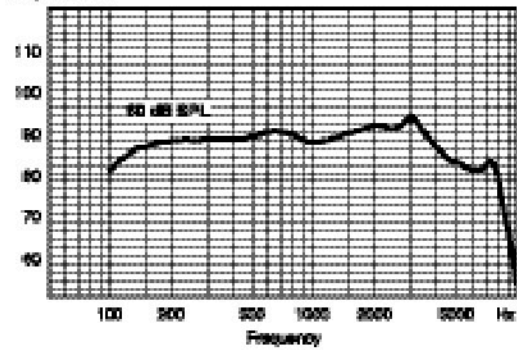

### Технические характеристики

Типичные данные, полученные после стандартных измерений с помощью чистого тона. Слуховой аппарат установлен в Compass в тестовом режиме 1, если нет других указаний. Измерения выполнены с использованием классического крюка и стандартной камеры для ITE

		IEC 60118-0	ANSI S3.22-2009 / IEC 60118-7
OSPL90	2500 Гц	120 дБ УЗД	110 дБ УЗД
	Пик	123 дБ УЗД	112 дБ УЗД
	Среднее значение	116 дБ УЗД	109 дБ УЗД
Акустический выход (Вход 60 дБ УЗД)	2500 Гц	102 дБ УЗД	91 дБ УЗД
	Пик	105 дБ УЗД	94 дБ УЗД
	Среднее значение	97 дБ УЗД	90 дБ УЗД
Макс. усиление (Вход - 50 дБ УЗД, Тестовый режим Compass макс. усиление)	2500 Гц	55 дБ	43 дБ
	Пик	61 дБ	51 дБ
	Среднее значение	56 дБ	48 дБ
Выход телефонной катушки (Вход 10 мА/м)		100 Гц - 9750 Гц	100 Гц - 8900 Гц
Частотный диапазон	500 Гц	0.6%	0.5%
	800 Гц	0.6%	0.4%
	1600 Гц	1%	0.7%
Нелинейные искажения (Вход 70 дБ УЗД)		25 дБ УЗД	24 дБ УЗД
Эквивалентный входной шум		0.7 мА	0.7 мА
Ток покоя		0.7 мА	0.75 мА
Срок службы батарейки/ часы (Тип 10 возд.-цинк, 90 мАч)		125 (>100)	125 (>95)
Невосприимчивость к помехам от мобильных телефонов		IRIL: -32/-18 дБ УЗД	U-rating: M3